


CONTRÔLE QUALITE INTERNE DE RADIOLOGIE DENTAIRE

Suite à l'arrêté du 8 décembre 2008, fixant les modalités du contrôle de qualité des installations de radiologie dentaire, qui impose aux radiologues et aux dentistes utilisant des panoramiques dentaires et/ou rétro alvéolaire de mettre en place des contrôles qualités internes.

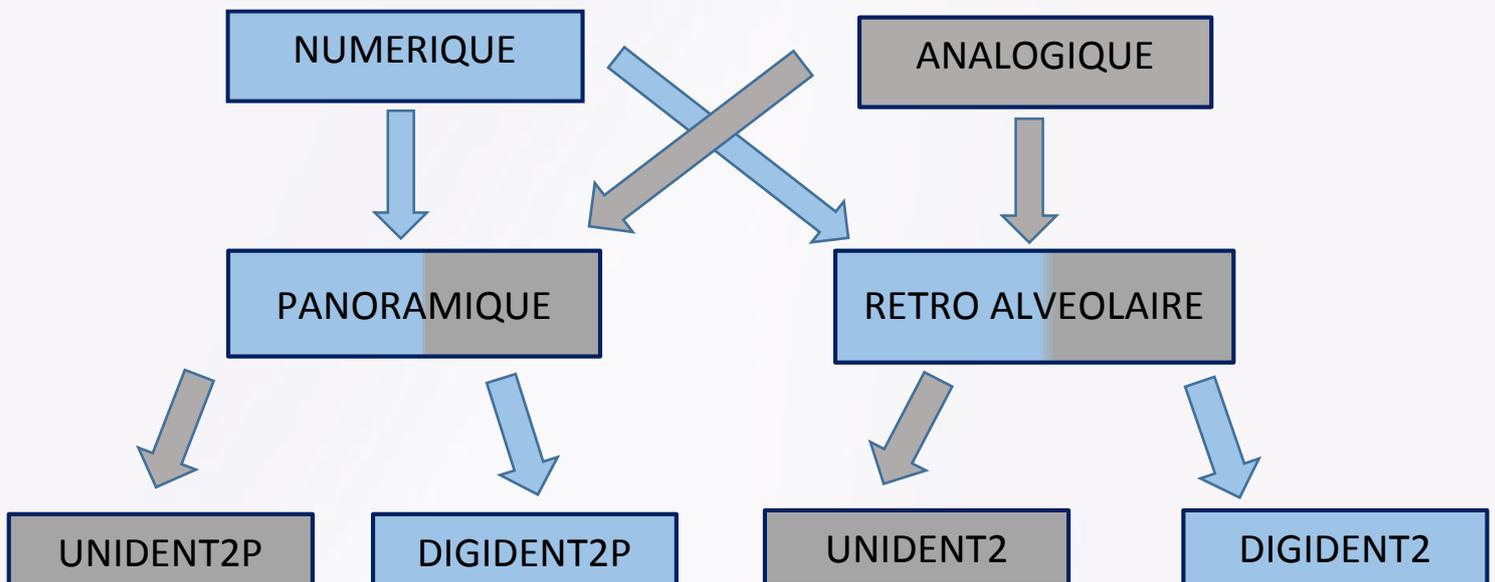

- Un Produit 100% conforme à la décision du 08/12/2008, développé et fabriqué en France
- Une gamme complète couvrant tous les équipements
- Simplicité d'utilisation grâce à la vidéo de démonstration intégrée
- Une totale autonomie dans la gestion de vos CQI grâce à la fourniture d'un logiciel dédié
- Présenté dans une valise pour simplifier le transport

MEDITEST SAS

184 Rue Tabuteau - BP 80345 - 78533 BUC CEDEX
Tel : +33 (0) 1 69 41 10 00 - Fax : +33 (0) 1 69 41 22 41
infos@meditest.fr - www.meditest.fr

Présentation de la valise

➔ Les Fantômes **DIGIDENT2(P)** ou **UNIDENT2(P)**

➔ Deux **filtres additionnels en cuivre** de 0,8 mm d'épaisseur pour les contrôles en panoramique

➔ **Une clé USB** contenant :

- Le logiciel pour la gestion des Contrôles Qualités et leurs archivages
- Une vidéo de démonstration
- Un manuel d'utilisation en Français



➔ **Une sangle de calage** pour les contrôles en rétro alvéolaire, afin de fixer différents formats de capteurs et de films au dos du fantôme.

➔ En option **un trépied télescopique** pour les contrôles en panoramique, lorsque l'ergonomie de la mentonnière ne permet pas une bonne stabilité du fantôme (Filetage standardisé intégré aux fantômes permettant de le fixer sur le trépied):

- Gain de temps (Marquer au sol la position de votre trépied une fois tous les réglages de positionnement effectués et utiliser votre marquage pour placer votre trépied pour de futurs contrôles).
- Absorbe les vibrations (N'étant pas rattaché au panoramique, votre fantôme ne subit aucune vibration).

UN SEUL FANTÔME SUFFIT SI VOUS POSSEDEZ UN PANORAMIQUE ET UN RETRO ALVEOLAIRE DE MÊME TECHNOLOGIE (NUMERIQUE OU ANALOGIQUE)

MEDITEST SAS

184 Rue Tabuteau - BP 80345 - 78533 BUC CEDEX
Tel : +33 (0) 1 69 41 10 00 - Fax : +33 (0) 1 69 41 22 41
infos@meditest.fr - www.meditest.fr